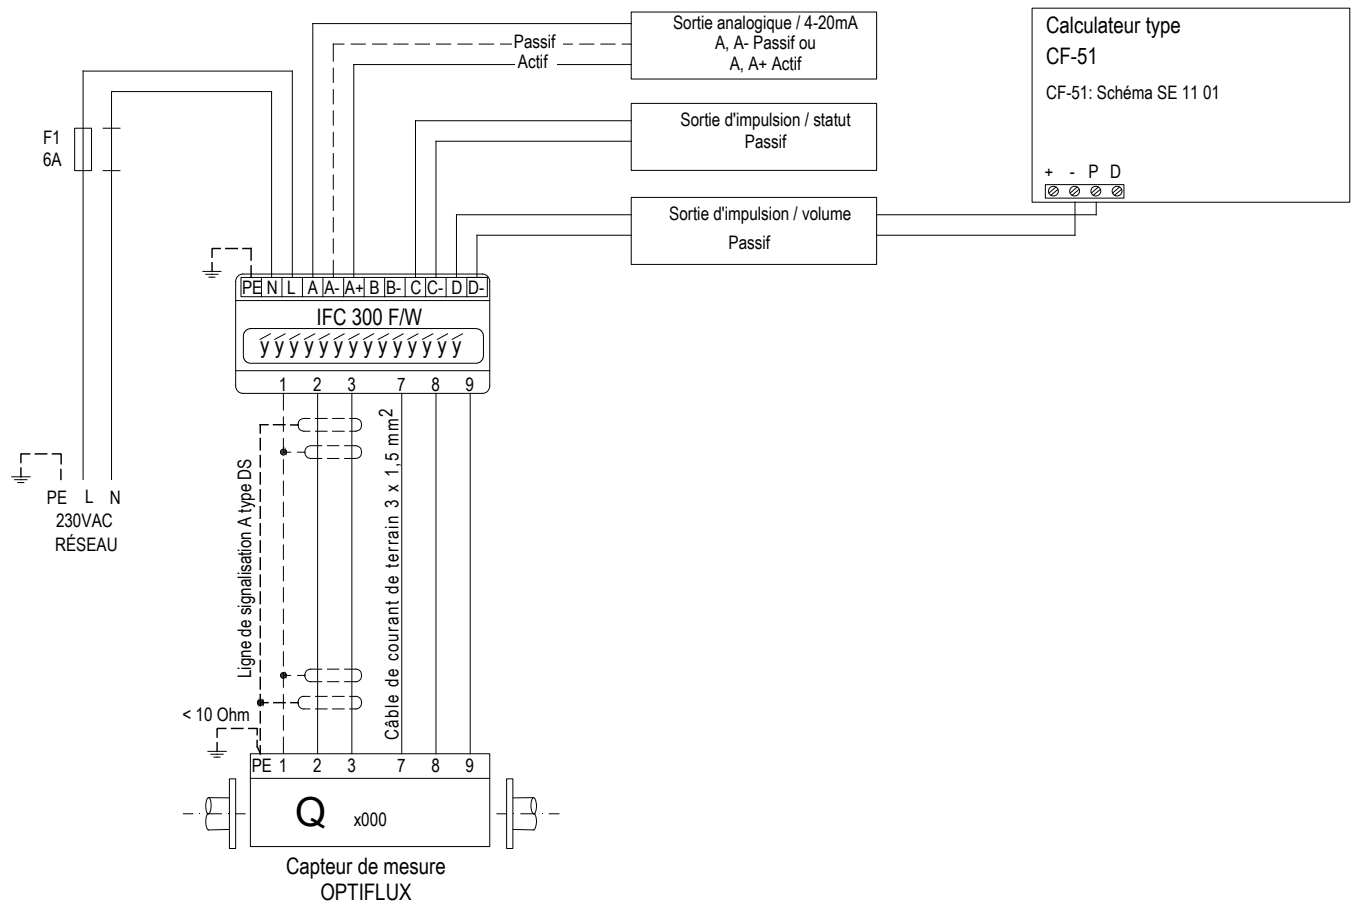


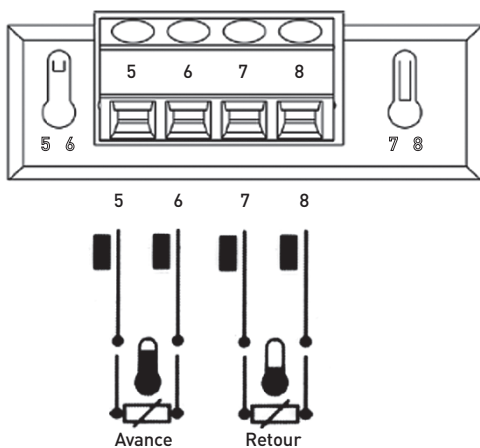


Schéma électrique

OPTIFLUX 4300W (CG 100) montage séparé sur calculateur CF-51 (unidirectionnel)



Raccordement de la sonde de température



Aperçu des cartes d'options

M-Bus + 2 compteurs d'eau

86	Entrée compteur d'eau 1 -
87	Entrée compteur d'eau 1 +
88	Entrée compteur d'eau 2 -
89	Entrée compteur d'eau 2 +
24	M-BUS
25	M-BUS

M-BUS + sortie d'impulsions E/V

16	Sortie d'impulsion énergie
17	Sortie d'impulsion énergie
18	Sortie d'impulsion volume
19	Sortie d'impulsion volume
24	M-BUS
25	M-BUS

Max 1 Hz
Largeur d'impulsion 250 ms
 $U_{\max}$ 30 V, $I_{\max}$ 20 mA
Optocoupleur, passif, indépendant de la polarité

LON + 2 compteurs d'eau

86	Entrée compteur d'eau 1 -
87	Entrée compteur d'eau 1 +
88	Entrée compteur d'eau 2 -
89	Entrée compteur d'eau 2 +
38	LON
39	LON
37	LON Alimentation électrique +
36	LON Alimentation électrique -

M-Bus Power + 2 compteurs d'eau

86	Entrée compteur d'eau 1 -
87	Entrée compteur d'eau 1 +
88	Entrée compteur d'eau 2 -
89	Entrée compteur d'eau 2 +
24	M-Bus
25	M-Bus

Max 5 Hz
Largeur d'impulsion 100 ms